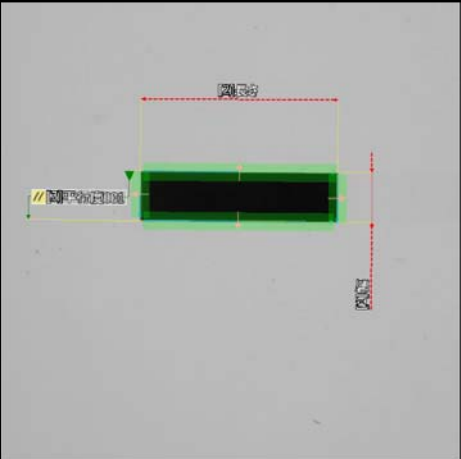


## 検査成績書

〒254-0013 神奈川県平塚市田村1-19-3  
株式会社スタンダードテストピース  
TEL0463-73-7255 FAX050-3737-0874

担当
市川
28.11.29
直樹

	品名	A1050P試験片
	測定機器	KEYENCE IM Series(IM Series)
	有効測定回数	6
	OK数	3
	OK率	50.000%
備考		

## &lt;測定項目情報&gt;

No	測定項目	設計値	単位	上限公差	下限公差
1	幅	5.000	mm	0.010	-0.010
2	長さ	20.000	mm	0.010	-0.010
3	平行度001	0.000		0.020	0.000

## &lt;統計結果&gt;

項目名	[1]幅	[2]長さ	[3]平行度001		
有効測定数	6	6	6		
OK数	3	6	6		
NG数	3	0	0		
NG率	50.000	0.000	0.000		
設計値	5.000	20.000	0.000		
上限規格値	5.010	20.010	0.020		
下限規格値	4.990	19.990	0.000		
最大値	5.034	19.999	0.020		
最小値	4.992	19.994	0.007		
平均値	5.013	19.997	0.014		
範囲(最大-最小)	0.042	0.005	0.013		
6σ	0.134829	0.014408	0.031616		
4σ	0.089886	0.009606	0.021078		
3σ	0.067414	0.007204	0.015808		
σ	0.022471	0.002401	0.005269		
CP	0.148336	1.388086	1.265164		
CPK	-0.042029	0.948525	0.390092		

項目名	[1]幅	[2]長さ	[3]平行度001		
1 (0001)	4.992	19.999	0.012		
2 (0002)	5.034	19.995	0.017		
3 (0003)	5.034	19.995	0.018		
4 (0004)	4.992	19.999	0.007		
5 (0005)	4.993	19.999	0.009		
6 (0006)	5.032	19.994	0.020		